

CONFERÊNCIA	
NOME	CONTÉM
VALIDADE (DIAS) 30 / 60 / 90 / 120 180 / 365	

Cód. CF.001 | Ø23mm

CONFERÊNCIA	
NOME	
Nº de Cápsulas	Valido por:
	30 60 90
	120 150 180
	210 240 270
	300 330 360
LOTE	Dias
CONF.	

Cód. CF.002 | Ø23mm

Nº Caps.:	
Téc.:	
Prod.:	
Cont.:	
Data:	/ /
Nº Lote:	

Cód. CF.003 | Ø23mm

CONTROLE DE QUALIDADE	
MANIP.:	
CONF. 1:	
CONF. 2:	
QUANT.:	

Cód. CF.004 | Ø23mm

COR			
MANIP.	ENC.	CONF.	QTD.
CÁPS Nº			
RASTREAMENTO			

Cód. CF.005 | Ø23mm

Cores Disponíveis
Azul e Verde

ON:				
BALANÇA	MANIP.	CONF.	ROT.	
QUANT.	LOTE:			
RASTREAMENTO				

Cód. CF.006 | Ø23mm

Cap:	Balança	OS:
MANIP.	Manip.	
Dose:	Conf.	
	Rot.	
RASTREAMENTO		

Cód. CF.007 | Ø23mm

CONFERÊNCIA	
CONTÉM	
<input type="checkbox"/> CAPS.COMP.	
<input type="checkbox"/> ML.	
<input type="checkbox"/> GRS.	
VISTO	

Cód. CF.008 | Ø23mm

Por razão técnica

Foram feitas ___ cáps.
ao invés de ___ cáps.

Portanto tomar ___ cáps.
ao invés de ___ cáps.

Cód. CF.009 | Ø23mm

CONFERÊNCIA	
NOME	Nº Cápsulas
ENC.	
CONF.	

Cód. CF.010 | Ø23mm

CONFERÊNCIA	
NOME	Nº Cápsulas
ENC.	
CONF.	

Cód. CF.011 | Ø23mm

CONFERÊNCIA:

CAPS.COMP.

ML.

GRS.


VISTO

Cód. CF.012 | 37x22mm


FARMACÓ

APROVADO


Cód. CF.013 | Ø23mm

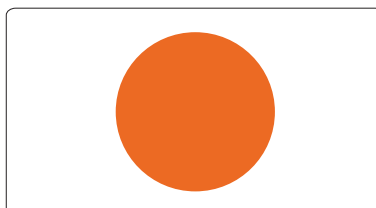


Cód. CF.014-LA | Ø16mm

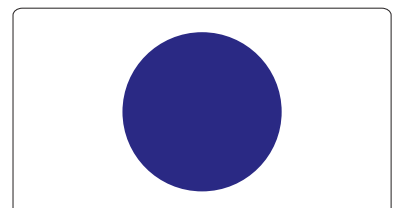


Cód. CF.014-AZ | Ø16mm

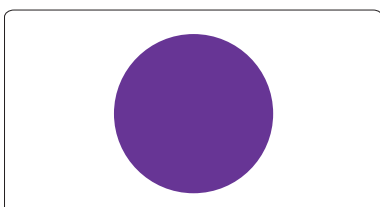


Cód. CF.014-RX | Ø16mm

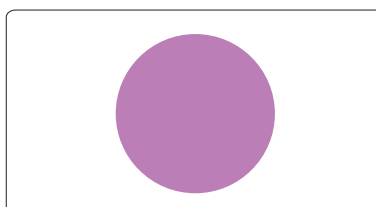

Cód. CF.014-RS | Ø16mm

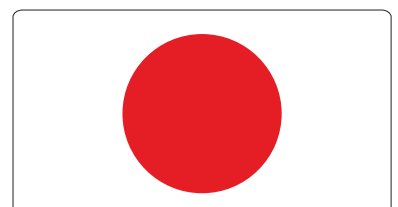

Cód. CF.014-VE | Ø16mm

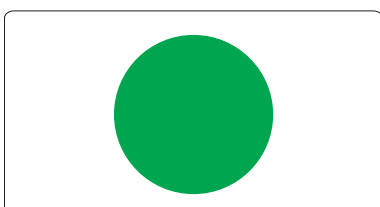

Cód. CF.014-GR | Ø16mm

Dose: _____


Qtd: _____ Nº: _____

() Inc _____ () Col.: _____

Reg.: _____ Data: _____

Visto: _____

Cód. CF.015 | 35x22mm

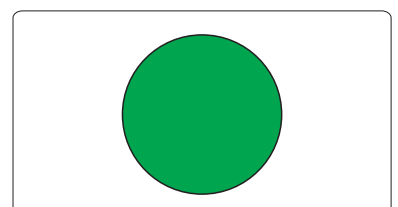

Cód. CF.016 | Ø23mm